


## 热安定性和腐蚀性测定仪

- 1 测定方法: GJB 1264.1
- 2 恒温浴要求: 8 个孔的铝块浴, 开孔直径约 20mm, 开孔深度约 210mm, 每个孔顶端加可旋盖, 加盖后整个空间长度约 260mm。
- 3 温度要求: 每个开孔内部要求恒温控制  $274\pm 1^{\circ}\text{C}$ , 温度均匀, 孔间温度差别在  $1^{\circ}\text{C}$  内。稳定控温 96h 以上。
- 4 其它: 温度计孔均匀设置, 最好有三个以上测量点; 计时器。

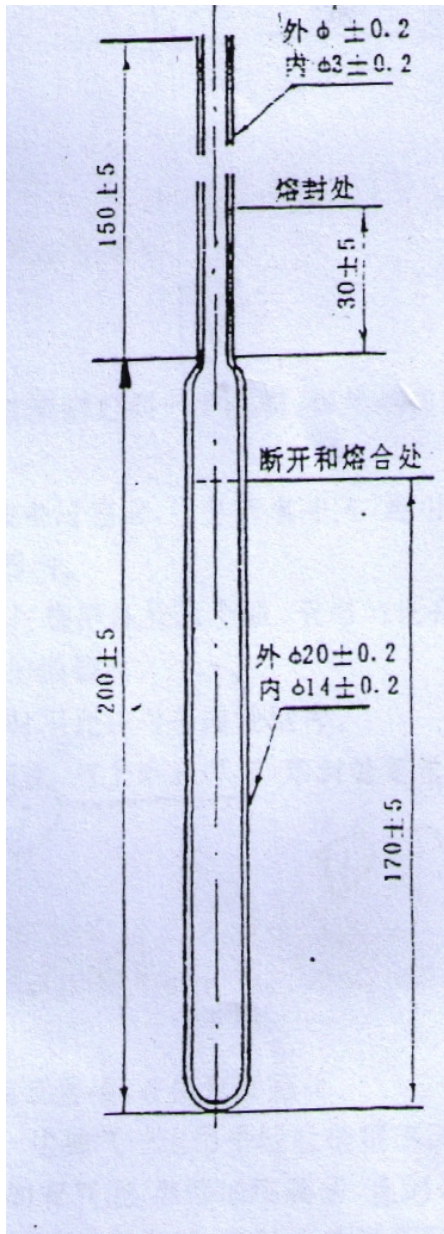

孔内放置玻璃管总长度约 230mm

单位: mm